



COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Narciso Santana da Silva ASSESSOR GAB/COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL	Para: Francisca Luzia de Pinho SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO PREGOEIRA	Data: 11/08/2017	Nº CI 3969/2017
--	---	---------------------	--------------------

Senhora Pregoeira,

Segue no anexo parecer solicitado sobre os itens a respeito da situação de conformidade ou não com as especificações exaradas no Edital do Pregão Nº 26/2017 da empresa HIPERDENTAL Material Hospitalar e Odontológico.

Atenciosamente,

Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande





Empresa	Item	Descrição	Marca	Situação
Hiperdental	1	Ambu adulto	SAFTI	Acetia
	2	Ambu pediátrico	SAFTI	Acetia
	8	Alavanca Seidin adulto direita	LM	Não acetia, pois não atende as especificações em relação a ausência de frestas e folgas (folos no anexo) e não foi possível verificar se a fabricação atende a NBR ISO 7153-1 e eletro polimento (Fabricante)
	9	Alavanca Seidin adulto esquerda	LM	
	10	Alavanca Seidin adulto reta	LM	
	11	Alavanca Apical adulto Reta	LM	
	12	Alavanca Apical Adulto Esquerda	LM	Acetia
	13	Alavanca Apical Adulto Direita	LM	
	16	Alicate ortodôntico N° 121	ABC	
	29	Cabo para Espelho N° 05	PREVEN	
	35	Cinzel goiva	LM	Não acetia, pois não atende as especificações em relação ao formato octogonal serrilhado e não é fabricado em aço inoxidável AISI 420 ou 440
	39	Cureta perno 1-10	Golgran	Não acetia, pois não foi possível verificar as especificações em relação ao tipo de aço AISI 420 ou 440 e eletro polimento (Fabricante)
	40	Cuba aço inoxidável	FAMI	Acetia
	42	Cureta Dupla tipo Gracey G7/G8	ABC	Não acetia, pois não atende as especificações em relação ao tipo de aço AISI 420 ou 440 (Fabricante)
	43	Cureta Dupla Gracey G11/12	ABC	Acetia
	48	Cureta com haste longa para Pulpotomia N° 01	LM	Não acetia, pois não foi possível verificar as especificações em relação ao tipo de aço AISI 420 ou 440 e eletro polimento (Fabricante)
	50	Cureta tipo Lucas n°85	LM	
	51	Cureta tipo Lucas n°86	LM	
	53	Cureta de dentina dupla n° 17	LM	
	54	Cureta de dentina dupla n° 18	LM	Não acetia, pois não foi possível verificar as especificações em relação ao tipo de aço AISI 420 ou 440 e eletro polimento (Fabricante)
	55	Cureta de dentina dupla n° 20	LM	
	56	Esculpidor Hollenback 3S	LM	
	63	Espátula para inserção de compositos (resina) N° 02 dupla	LM	
	65	Espátula para inserção de compositos (resina) N° 05 dupla	LM	Não acetia, pois não foi possível verificar as especificações em relação ao tipo de aço AISI 420 ou 440 e eletro polimento (Fabricante)




Empresa	Item	Descrição	Marca	Situação
Hiperdental	83	Grampos de Isolamento N.º A3	TECHNEW	Não aceita, pois não atende as especificações em relação à NBR ISO 7153-1 e eletro polimento (Fabricante)
	84	Grampos de Isolamento N.º 56	TECHNEW	Não aceita, pois não atende as especificações em relação à NBR ISO 7153-1 e eletro polimento (Fabricante)
	94	Grampos de Isolamento N.º WBA	TECHNEW	Não aceita, pois não atende as especificações em relação à NBR ISO 7153-1 e eletro polimento (Fabricante)
	96	Lamparina à álcool	LM	Não aceita, pois não atende as especificações em relação ao tipo de aço AISI 420 ou 440 (Fabricante)
	108	Sonda Milimetrada Goldman Fox n.º 4	LM	Não aceita, pois não atende as especificações em relação ao tipo de aço AISI 420 ou 440 e eletro polimento (Fabricante)
	126	Anestésico a base de cloridrato de mepivacaina a 3% (30 mg/ml) Sem vasoconstritor	Dentsply	Acetia
	128	Anestésico a base de cloridrato de prilocalina 3% com feipressina	Cristalia	Acetia
	150	Broca Carbide Estéril n.º 06 AR	Medin	Acetia
	164	Broca Diamantada n.º 1150 Cone Invertido, Topo arredondado, AR	FAVA	Acetia
	166	Broca Diamantada n.º 2068F Tronco Cônica Extremidade Plana, AR	FAVA	Acetia
	191	Broca LARGO n.º 2 (28 mm), tipo Helicoidal	MK	Acetia
	193	Broca LARGO n.º 3 (28 mm), tipo Helicoidal	MK	Acetia
	196	Broqueiro individual de alumínio	Maquira	Acetia
	197	Carbono em fita para oclusão ultrafina	Iodontosul	Não aceita, pois não se comprovou que o produto tenha a espessura determinada no Edital 026/2017 (anexo)
	199	Cartela Plástica para 04 RX Periapical	Iodontosul	Acetia
	208	Cimento Ionômero de Vidro autopolimerizável para ART, Cor A3. Kit com pó e líquido	FGM	Acetia

0.



Empresa	Item	Descrição	Marca	Situação
Hiperdental	220	Cunhas reflexivas sortidas	TDV	Acelta
	222	Dessensibilizante dentário em gel	Catech	Não acelta, pois não atende as especificações em relação à fórmula química do produto solicitado (Documento anexo).
	223	Digluconato de clorexidina 0,12%	Iodontosul	Não acelta, pois o frasco não apresenta válvula de retirada do produto.
	241	Evidenciador de placa bacteriana (pastilha)	Iodontosul	Acelta
	254	Fluor gel acidulado	Iodontosul	Acelta
	255	Fluor gel neutro	Iodontosul	Acelta
	270	Kit Mini - cirurgia estéril descartável	Best Fabril	Acelta
	299	Líquido fixador para radiografia	Calthec	Acelta
	300	Líquido revelador para radiografia	Calthec	Acelta
	321	Pedra pomes	Iodontosul	Acelta
	324	Ponteira de ultrassom odontológico (subgengival)	Schuster	Acelta
	339	Papel grau cirúrgico rolo 05 cm X 100m	Zematt	Acelta

Presença de frestas nas alavancas da marca LM – itens 8, 9, 10, 11, 12, 13 do Edital Pregão 026/2017

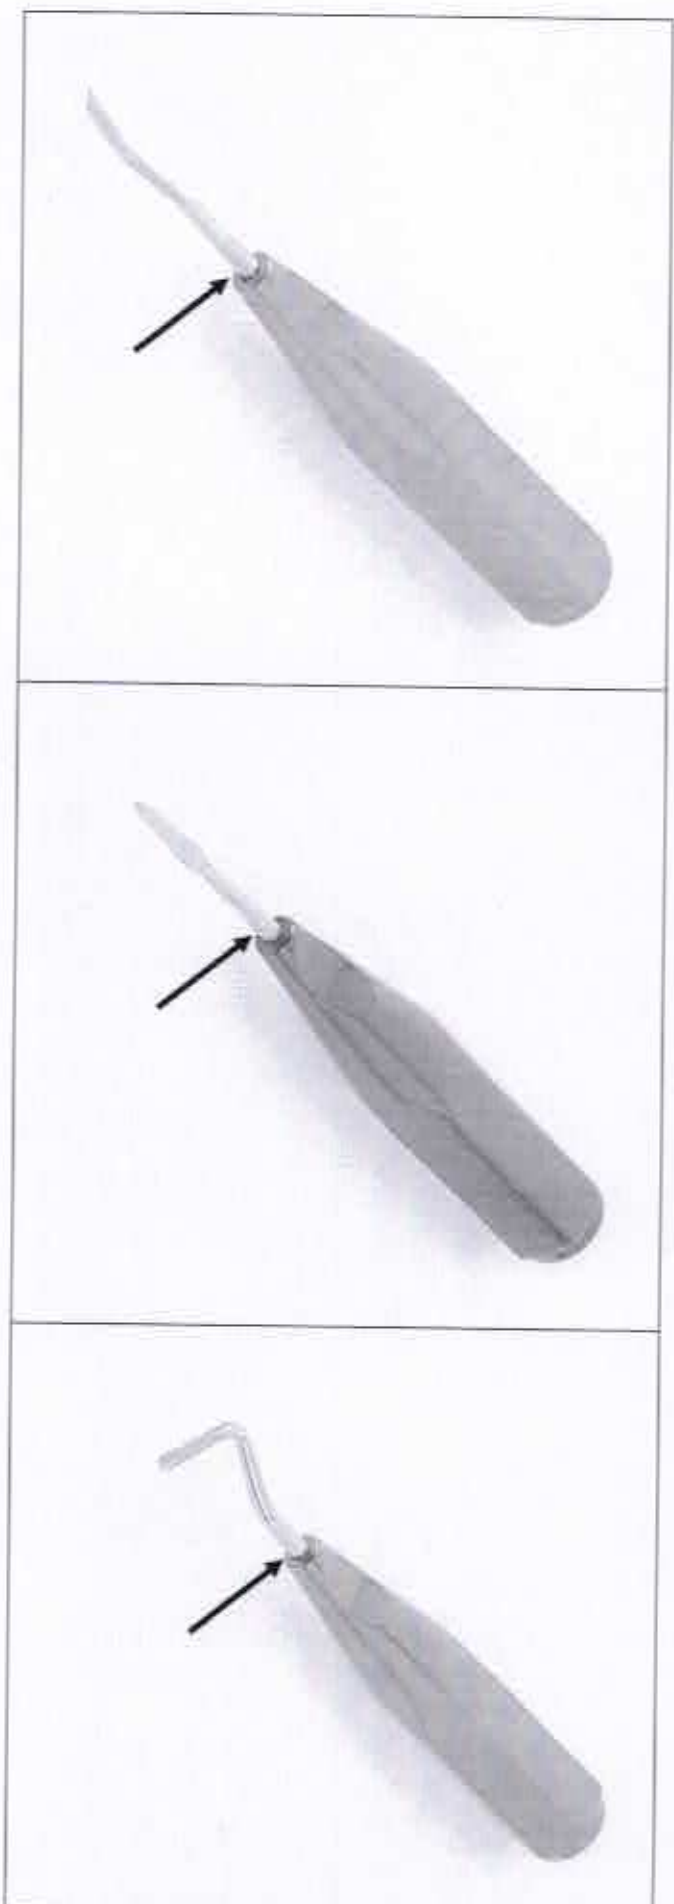



Item 29 - Cabo para espelho Nº 05



www.preven.com.br



www.preven.com.br

CABO PARA ESPELHO REDONDO

Indicação de Produto:
Produto utilizado para limpeza, manutenção e limpeza na instalação do espelho redondo.

Modelo do Produto:
Cabo Para Espelho

Composição do Produto:
Aço com revestimento de PVC.

Dimensões:
Comprimento: 100cm e 2
Diâmetro: 1/2"

Indicação de Produto:
Produto utilizado para limpeza

Manuseio e utilização do produto: O produto é utilizado para a limpeza do espelho redondo, sendo aplicado com um pano ou esponja úmida.

Precaução: Não utilizar o produto em superfícies sensíveis à abrasão, como vidro e plástico.

Exatidão: O produto é fornecido em embalagem de 10 unidades.


Atenção: O produto é fornecido em embalagem de 10 unidades.

Atenção: O produto é fornecido em embalagem de 10 unidades.

Atenção: O produto é fornecido em embalagem de 10 unidades.



Item 35 – Cinzel goiva, item 48 (Cureta haste longa pulpotomia Nº 01), itens 50 e 51 (Cureta Lucas Nº 85 e 86), 53, 54 e 55, itens 53, 54, 55 - Curetas de Dentina dupla Nº 17, 18 e 20, item 56 – Esculpidor de Hollenback 35, item 63 – Espátula para inserção de compositos (resina) Nº 02 dupla, item 65 - Espátula para inserção de compositos (resina) Nº 05 dupla e item 108 - Sonda Milimetrada Goldman Fox nº 4. Abaixo a descrição da indústria fabricante sem a especificação do aço utilizado.

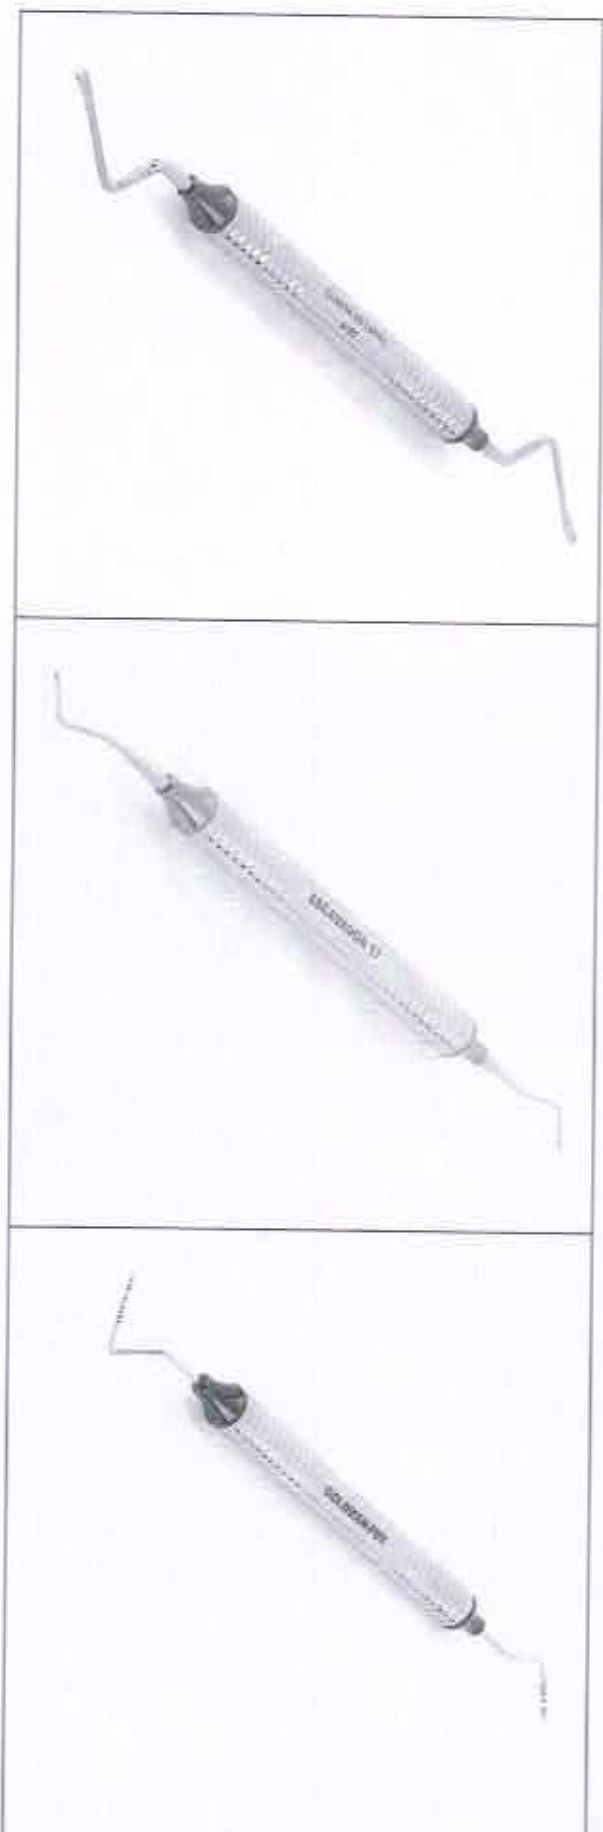

Características:

- Instrumento cirurgico não articulado cortante.
- Produzida em aço inoxidável

Apresentação:

- Embalagem c/ 1 unidade.

Validade:

- Indeterminado (conforme as instruções de uso da fabricante)

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



Marca: LM Instrumental

A LM Instrumental Odonto Médico iniciou suas atividades em 2004, com o compromisso de produzir e comercializar instrumentais odontológico, atendendo as expectativas e necessidades dos seus clientes com responsabilidade e seriedade. Produz peças e instrumentos que auxiliam em vários procedimentos de saúde, produtos de qualidade e competitividade em âmbito nacional, atendendo a legislação da ANVISA.

Instruções de Uso (fabricante)

Indicações de Uso

- Os instrumentos cirúrgicos são utilizados em intervenções cirúrgicas: odontológicas e médicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

Limpeza e Esterilização

- Todos os instrumentos devem ser limpos e esterilizados antes de cada utilização.
- Os instrumentos devem ser lavados imediatamente após sua utilização e antes que as secreções ou sangue possam secar. Aqueles que puderem, devem ser desmontados.
- A esterilização pode ser realizada a vapor, normalmente vapor saturado a uma temperatura de 134° C, ou ainda por autoclaves.
- Evitar o uso de esterilização a gás, por questão de proteção à saúde do paciente e pessoal envolvido nos processos e no próprio meio ambiente.

Manutenção e Conservação

- Em qualquer tipo de água há concentração de sais. Mesmo em uma água considerada portátil, existe a possibilidade de concentração de certos elementos químicos que poderão danificar os instrumentos.
- Se na água houver certa concentração de ferro, cobre, manganês, magnésio ou silício, poderá haver a formação de manchas com cores diversas: marrom, azul ou arco-íris. Nesse caso não se trata de corrosão e sim de manchas.
- O aquecimento e o esfriamento do instrumental durante a esterilização provocam dilatações e contrações a fim de evitar a perda prematura da elasticidade, é recomendado proceder a esterilização das pinças e porta agulhas com o fechamento da cremalheira apenas no primeiro dente.
- Autoclaves desreguladas podem apresentar umidade residual a qual poderá provocar manchas e/ou corrosão.

- Não armazenar um instrumento perto de produtos químicos que possam desprender gases corrosivos, a saber: cloro, iodo e ácidos em geral.
- Cada instrumento foi criada e desenvolvido para executar uma determinada função, portanto, ele não deve ser utilizado fora destas condições. Os instrumentos utilizados fora das suas condições normais de trabalho podem quebrar, ou ter sua vida útil reduzida.

Item 40 – Cuba aço inoxidável Aço indústria FAMI - 304



EMBALLAGENS E RECIPIENTES

Uma complexidade adicional para a pesquisa é a própria administração, com a sua complexidade de ser um processo de gestão. Há a performance do processo administrativo, o gerenciamento, a gestão, a administração e a produção da própria administração.



ESTUDIOS PERSONALIZADOS

Construção de pontos superlativos e
superlativos para ser flexionados
em qualquer tempo verbal, de acordo
com o grau de intensidade do verbo
principal, e qualificação temporal e no
presente que servem de colônias
superlativas.



CONTAINER SYSTEM

Unirea de emigranți din cele două țări este un proiect de interes național, care trebuie să aibă în vedere atât nevoile economice, cât și cele culturale ale comunității. Este important să se creeze oportunități de colaborare și schimb de experiență între emigranți și comunitățile din țările de origine. Astfel, se poate contribui la dezvoltarea economică și culturală a țării și la creșterea coeziunii sociale.



BIOSECTEURS/SECTEURS

[illegible]



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

Itens 83, 84 e 94 – Grampos para isolamento marca Technew

BEM-VINDO À TECHNEW

Mônica Costa - 08 0000 0000



HOME CERTIFICADOS NOTÍCIAS PRODUTOS FALE CONOSCO

Nome do produto



Produtos



GRAMPOS

Para Bloqueio de Acesso

- Conquistou em 2010 o prêmio de
- Melhor produto inovador e sustentável
- Melhor produto inovador e sustentável
- Melhor produto inovador e sustentável
- Melhor produto inovador e sustentável
- Melhor produto inovador e sustentável

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Várzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

Item 197 - Carbono em fita para oclusão ultrafina da marca Iodontosul



Alimentação: 33.0334.2578

In da f. w g°

Home

Área Empresa

Emprego

Tribuna Odeonca

SAP

Concursos

Busca

Q

PRODUTOS

Carbão para oclusão

BAIXAR PRINCIPAIS PRODUTOS

Carbon paper - Papel Articulação c/ 12 folhas - Bicolor (vermelho e azul)



Papel carbono dupla-face bicolor (azul-vermelho) para articulação, melhor performance e precisão.

Av. Castelo Branco, 2500, Água Limpa, Varzea Grande – MT – 78.125-700
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

10

Item 222 – Dessensibilizante dentinário em gel marca Caltheed

Av. Castelo Branco 2500 Água Limpa Várzea Grande - MT - 78125-700