



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

Análise e Julgamento de Recursos Administrativos

I - Preliminar

Trata-se da análise ao recurso administrativo, impetrado, pela licitante, **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ: sob nº05. 743.288/0001-08; no Pregão Eletrônico de nº 03/2019, contra habilitação no item 25 da empresa **CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A**, inscrita no CNPJ sob nº 03.620.716/0001-80.

II – Da Tempestividade

O edital do certame em epígrafe dispõe:

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito

12.3 Após a manifestação de intenção de interpor recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de **03 (três) dias** para apresentar o memorial recursal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste edital.

12.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

12.6 Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

Por se tratar de pregão eletrônico foi marcado para manifestação de intenções de recurso em 23/05/2019 às 15: h00min.

Como a empresa recorrente **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, manifestou suas intenções de recorrer, o recurso foi deferido em 27/05/2019, a empresa protocolou seu recurso em 28/05/2019, sendo **TEMPESTIVA** a peça recursal interposta.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

Assim, a pregoeira e os Membros dessa Comissão equipe técnica CONHECEM o Recurso Administrativo ora apresentado.

III – Dos Fatos e Pedidos

Expõem as recorrentes as razões de fato e de direito.



Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08, Inscrição Estadual: 10.366.017-8, Inscrição Municipal: 190210-4
Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul, Goiânia, Goiás CEP: 74083-300, Telefone: (62) 3241.5355
www.hospcom.net

Goiânia, 29 de maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019
PROCESSO Nº 561487/2018
ABERTURA DIA 26/03/2019 ÀS 10:00 HS

RECURSO ADMINISTRATIVO

A HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 05.743.288/0001-08, com sede na Rua 104, nº 74, Setor Sul, na cidade de Goiânia / Goiás, vem através deste, deste recurso administrativo protestar contra o licitante CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A CNPJ: 03.620.716/0001-80 com a Marca CMOS DRAKE / VIVO, devido ao fato de ofertarem para o item 25 - CARDIOVERSOR, É notório que a mesma não atende plenamente a todas as solicitações do termo de referência como vemos abaixo:

- "DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A IP44".

Está claro, no manual do produto da CMOS DRAKE, que o mesmo não atende ao grau de proteção contra a entrada de líquidos no aparelho, como mostra a página 110 do manual do mesmo, disponível no site da ANVISA:

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL139813-3-199531.PDF>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



HOSPCOM
Porque a vida exige precisão.

Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08, Inscrição Estadual: 10.366.017-8, Inscrição Municipal: 199210-4
Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74063-300 Telefone: (62) 3241.5555
www.hospcom.net

Cardioversor	
17. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Cardioversor, portátil, transportável, alça para transporte, microprocessado, utilizado para monitorização cardíaca dos sinais vitais, possui suporte para fixação das pás no próprio equipamento. Equipamento funciona de forma simplificada passos 1-2-3. Através do acesso ao menu do equipamento pelo botão giratório (NAVEGADOR), configura-se e ajusta todos os parâmetros. Utilizado em pacientes adulto, infantil e neonatal.	
De acordo com as Normas técnicas harmonizadas:	EN 980:2008, EN 1041:2008, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 13485:2012, EN ISO 14155-1:2009, EN ISO 14971:2012, EN ISO 15255:2007, EN 60601-2-4:2003, ABNT NBR IEC 60601-1:2010, ABNT NBR IEC 60601-2-27:2011, ABNT NBR IEC 60601-2-48:2001, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2007, ABNT NBR IEC 60601-2-30:2000, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-8:2010, EN 62304:2008 e outras.
Certificações Relevantes	Certificação de Produto - INMETRO Registro no Ministério da Saúde: 80058130015
Tipo de proteção contra choque elétrico	Classe II
Grau de proteção contra choque elétrico	Aplicável a cada módulo. ECG/ Desfibrilador/Modo DE - Marcapasos - Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação. SPO2/ PNI/ EICO2 - Parte aplicada de tipo BF à prova de desfibrilação.
Proteção contra penetração nociva de água e de material particulado	IP33

Esse é um tipo de proteção extremamente importante, que declara que o equipamento é resistente a uma quantidade de água a qual pode ser exposto. O não cumprimento deste requisito pode comprometer a segurança da equipe durante o uso do equipamento, comprometer também a durabilidade do mesmo, considerando que tal equipamento será utilizado em ambientes de urgência e emergência onde fatores adversos estarão presentes.

O equipamento não atende a solicitação:

"BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO".

Fica claro, nas páginas 100 e 101, do manual da ANVISA, que o mesmo precisa de chave Philips para a troca da mesma, vejamos abaixo:

<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL39813-3-199531.PDF>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



HOSPCOM

Porque a vida exige precisão.

Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA

CNPJ: 05.743.288/0001-08. Inscrição Estadual: 10.356.017-8. Inscrição Municipal: 199210-4.

Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241.5555.


www.hospcom.net

Substituição da bateria

Ao fim da vida útil da bateria a bateria deverá ser substituída seguindo os procedimentos abaixo:

O compartimento da bateria encontra-se na parte inferior do equipamento, para acessá-la deite o equipamento.

1. Com auxílio de uma chave philips retire os 4 parafusos da tampa do compartimento da bateria.
2. Puxe o compartimento bateria.
3. Desconecte a bateria do equipamento.

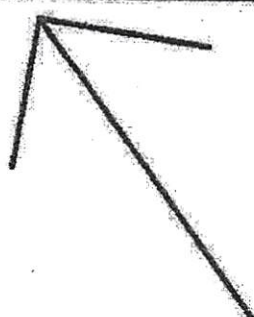


Ativar
processo
100

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08 Inscricao Estadual: 10.366.017-8, Inscricao Municipal: 159210-4
Endereço: Rua 104 n° 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241.5555
www.hospcom.net



Cardioversor Bifásico VIVO

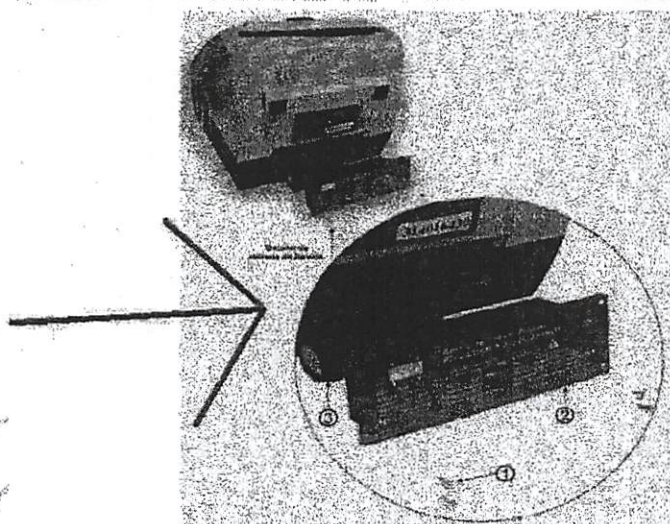


Figure 62 - Substituir o pack de bateria

O equipamento ainda não atende na solicitação referente a bateria:

- "AS MESMAS DEVE POSSUIR LEDS DE INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CARGA".

As baterias do modelo da CMOS DRAKE, não possuem led's de indicação, que demonstram que as mesmas, estão carregadas e em estado de prontidão para o uso do produto, pois são internas, impedindo a verificação do nível de carga na própria bateria, como verificamos na página 44 do manual da ANVISA:

[http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL\[39813-3-19953\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[39813-3-19953].PDF)



Cardioversor Bifásico VIVO

6. ALIMENTAÇÃO

O cardioversor VIVO funciona com alimentação da rede elétrica ou por suas baterias internas. Em caso de queda de energia as baterias alimentam o equipamento automaticamente, não havendo necessidade de nenhuma interferência do usuário.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



HOSPCOM

Porque a vida exige precisão.

Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA

CNPJ: 05.743.288/0001-08, Inscrição Estadual: 10.366.017-8, Inscrição Municipal: 199210-4

Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241.5555

www.hospcom.net

O recurso de leds, na própria bateria, é bastante útil para verificação da situação de carga da mesma, com o equipamento desligado. Pois, com um simples botão, localizada na própria bateria, os leds indicam se o equipamento está em estado de prontidão para o uso. Isso é imprescindível em um equipamento de urgência como um cardioversor. Sem esse recurso, o usuário é obrigado a ligar o equipamento, todas as vezes que quiser verificar a condição da bateria.

O equipamento não atende a solicitação:

"DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA, SELECIONÁVEL NO PAINEL FRONTAL E NAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, COM BOTÃO DE SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE".


Os equipamentos de Cardioversão/Desfibrilação são destinados ao atendimento no suporte a vida, com base neste fato, toda facilidade e assertividade que o equipamento puder ofertar para agilizar os ajustes necessários no momento da aplicação da terapia se torna indispensável. O equipamento do fabricante CMOSDRAKE possui em suas pás apenas os botões para disparo, ou seja, não possui botões dedicados para 1º seleção de energia, 2º carga e 3º disparo (choque).

A imagem abaixo retirada do manual do equipamento comprova o apontamento.

PÁS DE CHOQUE
PERMANENTES
ADULTO/INFANTIL

LT27275

CMOSDRAKE
exclusivamente

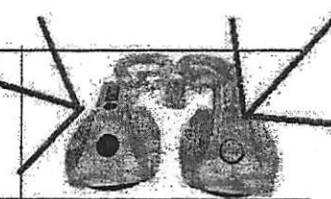

DO MERITO

A presente licitação, como procedimento administrativo que é, rege-se pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e respectivas alterações. Com efeito, a Lei nº 8.666/93 traz em seu bojo os princípios norteados da licitação, insculpidos em seu art. 3º "in verbis":

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08. Inscrição Estadual: 10.366.017-8. Inscrição Municipal: 199210-4
Endereço: Rua 104 nº 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241-5555
www.hospcom.net

*Art. 3º: A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifos nossos)".

A Administração Pública, em um processo de licitação, não deve desobedecer as regras que ela mesma estabeleceu no instrumento convocatório, é necessário seguir estritamente as disposições constantes do edital, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para certificar o tratamento isonômico entre os licitantes.

DO PEDIDO

Solicitamos a imediata desclassificação da empresa CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, uma vez que as mesmas não atendem aos requisitos mínimos solicitados no termo de referência.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Jackeline Teodora Coelho

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

JACKELINE TEODORA COELHO

Representante

RG: 685950 SSP/TO

CPF: 015.305.151-57

Tel.: (62) 3241 5555

licitacao@hoscom.net



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

IV – Da Contrarrazões ao Recurso



ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2019
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2019

CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.620.716/0001-80, sociedade com sede situada na Avenida Regent, 600, Sala 205, Alphaville - CEP: 34018-000 - Nova Lima/MG ("Recorrida"), neste ato representada por sua procuradora, abaixo assinada na forma da lei, vem do item 11, subitem 11.4, do Edital de Licitação, apresentar suas Contrarrazões aos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. e HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ("Recorrentes"), pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

I - DOS FATOS

Em 18/01/2019, foi aberta a sessão do Pregão Eletrônico n.º 003/2019 promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, visando o "registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares e móveis hospitalares para atender as necessidades da atenção básica, secundária e terciária da Secretaria Municipal de Várzea Grande-MT".

Após abertura do Pregão e realização da fase de lances, procedeu a análise da proposta comercial da Recorrida, CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A, tendo sido classificada e habilitada no certame no Item 25.

Frente a tal decisão, as Recorrentes interpuseram Recurso Administrativo, alegando, em síntese que o equipamento ofertado pela Recorrida se encontra em desacordo com as exigências técnicas do Instrumento Convocatório e pugnando, ao final, pela desclassificação de sua proposta.

Todavia, serve-se a Recorrida da presente Contrarrazões ao Recurso Administrativo, para demonstrar, por derradeiro, seu efetivo cumprimento às exigências editalícias, devendo ser mantida a decisão impugnada, pelos seus fatos e fundamentos, senão veja-se:

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



II. DAS RAZÕES DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE

Inicialmente, cumpre à Recorrida salientar que, em que pese a argumentação trazida em sua peça recursal, verifica-se que se trata de uma medida desesperada das Recorrentes na tentativa de induzir este I. Pregoeiro à uma interpretação equivocada do referido edital.

As Recorrentes Instramed e Hospcom, em seus recursos, informam que o modelo Vivo da Marca Cmos Drake possui IP 33 e não atende as características técnicas descritas no edital para o item 25 – Cardioversor, qual seja:

"DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A IP44"

Contudo, percebe-se que a Recorrente não se atentou a proposta comercial apresentada pela Recorrida, assim como os demais documentos apresentados na fase de habilitação quais comprovam que o Cardioversor Vivo possui IP 44, senão vejamos:

Apresentamos abaixo imagens da página 3 da proposta comercial.



Bateria	Bateria interna, com capacidade de até 220 choques (disparos) com carga de 200J; 50 choques (disparos) com carga de 360J ou até 4 horas de monitoramento.
Recarga da Bateria	Carregador de bateria interno que realiza todo o controle de carga da bateria automaticamente com tempo de carga de aproximadamente 4 horas.
Tempo de carga	Com uma bateria nova e plenamente carregada ou pela alimentação da rede elétrica, seu tempo de carga é menor que 5 segundos para 200 joules e menor que 8 segundos para 270 e 360 joules.
Anula carga	Descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo, ou manualmente através da tecla anula carga a critério do usuário em qualquer tempo.
Cronômetro	Relógio contador de segundos, data e contador de choques.
Teste no equipamento	Realiza auto teste diário ao ser ligado.
Teste nas pás	Realiza teste de funcionamento das pás com indicação luminosa.
Idiomas disponíveis**	Português, Espanhol e Inglês.
Sincronização	Realiza disparo sincronizado com o complexo QRS, com o tempo de entrega de energia menor que 20ms. Tempo máximo de retardo para estabilização do sinal em 5 segundos após conexão ideal do sensor ao paciente.
Peso Total	Aproximadamente 4,0 kg incluindo todos os acessórios.
Alimentação Automática	90 a 240 VAC – 50/60 Hz – Fonte de alimentação integrada – Bivolt.
Condições da temperatura	0-50°C, armazenamento: 0-70°C, unidade operacional: 10-95% RH, sem condensação, compatibilidade eletromagnética irradiada e conduzida CISPR11.
Grau de Proteção	IP 44
Modelo	VIVO
Marcas/ Fabricante	CMOS DRAKE
Procedência	NACIONAL
RMS	60058130015

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018


Pregão Eletrônico nº03/2019



Junto aos documentos apresentados disponibilizamos o relatório de ensaio "Relatório de Ensaios IP44 0113_01_MED_2017 Rev.00 - Cardioversor Vivo", o qual comprova que o modelo Vivo de nossa linha de fabricação possui IP 44.

Relatório de teste emitido sob a responsabilidade de:

intertek



Relatório de Ensaios ABNT NBR IEC 60529 Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos	
Relatório numero.....	0113_01_MED_2017 Rev.00
Data de emissão.....	03 de Agosto de 2017.
Numero total de páginas.....	49 páginas.
Testado por (+assinatura).....	William Rosa Maschio.
	 William Rosa Maschio
Aprovado por (+assinatura).....	Caio Garcia Piccirillo.
	 Caio Garcia Piccirillo
Laboratório.....	Intertek laboratórios de ensaios - Unidade São Caelano do Sul.
Endereço.....	Av. Senador Roberto Simonsen 1302 - Térreo - Cerâmica - São Caelano do Sul - SP - CEP 09530-402
Solicitante.....	Cmos Drake do Nordeste Ltda.
Endereço.....	Av. Coronel Benjamim Guimarães - Minas Gerais / Brasil - CEP: 32.235-000.
Especificação do ensaio:	
Norma.....	ABNT NBR IEC 60529:2011.
Procedimento.....	IO ETL SP 60529.
Método não normativo.....	N/A.
Folha de registro.....	FO ETL SP - 001 rev. 02 - IO ETL SP 60529.

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



intertek

Página 2 de 49

Relatório N°. 0113_01_MED_2017 Rev.00

"Laboratório de ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0078"

Descrição do item sob ensaio	Cardioversor.
Marca registrada	 cmos drake tecnologia que salva vidas
Fabricante	Cmos Drake do Nordeste Ltda.
Modelo	Vivo.
Classificações	--

Cópia da marcação:



FO ETL SP - 001 rev. 02 - IO ETL SP 60529

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



intertek

Página 3 de 49 Relatório No. 0113_01_MED_2017_Rev.00

Laboratório de ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0678.

Particularidade de ensaio.....	---
Classificação de instalação.....	Não aplicável.
Tipo de conexão.....	Não aplicável.
Legenda para os resultados obtidos:	
- Não Aplicável - Ensaio não aplicável à amostra ensaiada	N/A (Não Aplicável).
- Atende - Ensaio Atende ao Requisito Normativo	P (Atende).
- Não Atende - Ensaio Não Atende ao Requisito Normativo.....	F (Não Atende).
Teste	---
Data de recebimento da amostra.....	31 de Julho de 2017.
Data(s) de realização do(s) ensaio(s):	01 de Agosto de 2017 até 03 de Agosto de 2017.
Este relatório contém resultados oriundos de laboratórios subcontratados	SIM ☐ NÃO ☒
Caso a resposta seja sim para o item acima, detalhar	---
Observações gerais:	
Os resultados dos ensaios apresentados neste relatório referem-se apenas ao objeto ensaiado, não sendo extensíveis a qualquer outra amostra ou lote de amostras.	
Este relatório somente poderá ser reproduzido na íntegra, e com a autorização por escrito do laboratório de ensaio da Intertek do Brasil.	
Os ensaios realizados e apresentados neste relatório foram passados ao laboratório pelo solicitante dos ensaios, sendo que o laboratório de ensaios da Intertek do Brasil não indicou ao solicitante a execução de nenhum ensaio.	
A amostra ensaiada foi enviada ao laboratório de ensaios da Intertek do Brasil pelo solicitante, sendo que o laboratório não é responsável pela representação da amostra perante lotes ou processos de fabricação.	

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



intertek

Página 4 de 49 Relatório: No. 0113_01_MED_2017 Rev.00

"Laboratório de ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0678."

Item Normativo	Descrição dos detalhes do ensaio	Observações	Veredito
11	Requisitos gerais para os ensaios	---	P
11.1	Condições atmosféricas para os ensaios de água ou poeira. Salvo especificações contrária em norma pertinente ao produto, os ensaios devem ser realizados sob condições atmosféricas normalizadas e conforme abaixo: Faixa de Temperatura : 15°C a 35°C Umidade Relativa : 25% a 75% Pressão atmosférica : 86 kPa a 106 kPa (860 mbar a 1060 mbar)	Temperatura durante a realização dos ensaios : <u>Mínima</u> : 19,9 °C <u>Máxima</u> : 23,1 °C Umidade relativa durante a realização dos ensaios : <u>Mínima</u> : 53,5 % <u>Máxima</u> : 68,6 % Pressão Atmosférica: 1020 hPa Instrumento utilizado: ETL SP 0092 – Termohigrômetro.	P

intertek

Página 5 de 49 Relatório: No. 0113_01_MED_2017 Rev.00

"Laboratório de ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0678."

Item Normativo	Descrição dos detalhes do ensaio	Observações	Veredito
13.2	Condições de ensaio para o primeiro numeral característico 1, 2, 3, 4		P
	O calibrador é empurrado contra todas as aberturas do invólucro com a força especificada na tabela 7 (mostrada a seguir).	Primeiro numeral característico: 4 Calibrador utilizado : Haste rígida de aço com 1,0 mm de diâmetro com extremidades isentas de rebarbas. Força Aplicada : 1 N ± 10%. Instrumento utilizado: ETL SP 0051 – Haste 1,0 mm. ETL SP 0028 – Dinamômetro digital.	P

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



intertek

Página 6 de 49 Relatório No. 0113_01_MED_2017 Rev.00

"Laboratório de ensaios acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0878"

13.3	Condições de aceitação para os primeiros numerais característicos 1, 2, 3, 4	Observações	Veredito
	A proteção é satisfatória se o diâmetro total do calibrador especificado na tabela 7 não passa por qualquer uma das aberturas. NOTA - Para os primeiros numerais característicos 3 e 4, os calibradores especificados na tabela 7 são projetados para simular objetos estranhos que podem ser esféricos. Em situações que o invólucro possuir um caminho de entrada indireto ou tortuoso e que exista alguma dúvida sobre o ingresso de um objeto esférico capaz de movimentar-se, pode ser necessário examinar os desenhos ou prever acessos especiais para o calibrador a ser aplicado com a força especificada na(s) abertura(s) onde o ingresso tem que ser verificado.	Primeiro numeral característico: 4 O calibrador não ultrapassou nenhuma abertura durante o ensaio.	P

Resta esclarecer que o equipamento é fabricado com grau de proteção IP 44, conforme páginas do relatório apresentados acima.

Quanto o manual disponível no site da Anvisa sob RMS 80058130015, a solicitação de alteração do mesmo já foi encaminhada e deferida, porém o Órgão competente ainda não atualizou o site conforme publicação no diário oficial abaixo:

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



A Recorrente Instramed ainda alega que o modelo Vivo não atende o quesito quanto a bateria, novamente uma vã tentativa de tumultuar e frustrar o processo.

Vejamos trecho do descritivo com a respectiva característica técnica, *in verbis*:

"BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍON LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 (DUAS) HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE ECG SEM A NECESSIDADE DE TROCA OU RECARGA DURANTE ESTE PERÍODO; BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO."

O equipamento apresentado pela Recorrida possui características superiores ao solicitado no edital, conforme pode ser observado nas páginas do manual, onde evidencia que o Vivo tem capacidade de 4 horas de monitorização sem necessitar de recarga.

Abaixo apresentamos a página 44 do manual:

ALIMENTAÇÃO / BATERIA

O Cardioversor Bifásico Vivo dispõe de bateria interna de Lítio Polímero, com capacidade de até 220 choques (disparos) com carga de 200J; 50 choques (disparos) com carga de 360J ou até 4 horas de monitoramento. Possui um carregador de bateria interno que realiza todo o controle de carga da bateria automaticamente com tempo de carga de aproximadamente 4 horas. Opcionalmente para aumentar a capacidade de choques e tempo de monitorização, é possível também utilizar baterias ou alimentação externa adicionais, sendo:

- a) O equipamento possui conector para alimentação em ambulâncias e aeronaves. Em ocasiões onde não se dispõe de rede elétrica por períodos de uso prolongado basta conectar o equipamento a alimentação externa preservando assim a bateria do equipamento para situações em que seja necessário deslocar o equipamento até o local onde está o paciente. Não utilize o cabo de rede quando o cabo de alimentação para ambulância estiver sendo utilizado (acessório opcional);
- b) Baterias externas (reserva) de fácil substituição com carregador próprio e tempo máximo de carga de aproximadamente 4 horas.

Baterias externas podem ser entregues em versões de capacidade de cargas diferentes que variam entre 2 horas a 15 horas de monitoramento ou 50 choques a 220 choques consecutivos respectivamente com carregador próprio.

STATUS DIGITAL DA CARGA DA BATERIA

No painel do equipamento existe um indicador em forma de LED conforme abaixo:

- ❖ Ligado à rede elétrica:
- ❖ Estado da bateria (status) Carregando; Carga;
- ❖ Estado da bateria (status) Descarregada;.

Nível de Carga da Bateria

44

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



Insta esclarecer que, o descritivo solicitou que o equipamento possua bateria com fácil remoção, sem a necessidade de desmontar o equipamento. As páginas 100 e 101 do manual são claras, para realizar a troca da bateria faz necessário retirar a tampa do compartimento da bateria para retirar o PACK e não desmontar o equipamento.

Substituição da bateria

Ao fim da vida útil da bateria a bateria deverá ser substituída seguindo os procedimentos abaixo:

O compartimento da bateria encontra-se na parte inferior do equipamento, para acessá-la deite o equipamento.

1. Com auxílio de uma chave phillips retire os 4 parafusos da tampa do compartimento da bateria;
2. Puxe o compartimento bateria;
3. Desconecte a bateria do equipamento.



Cardioversor Bifásico VIVO

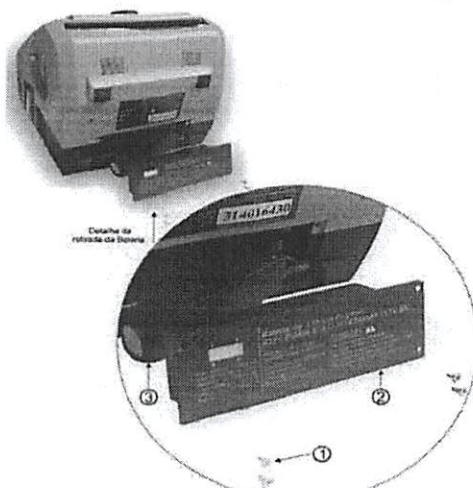


Figura 63 – Substituir o pack de bateria

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018


Pregão Eletrônico nº03/2019



A Recorrente Hospcom, alega que o modelo Vivo da nossa linha de fabricação não atende os LED's de indicação de carga da bateria, uma vez que a mesma é interna.

A Cmos Drake, pioneira na fabricação de Cardioversores e Desfibriladores possui LED's indicativos do nível de carga no display do equipamento, uma vez que é muito mais eficiente.

Abaixo seguem imagens das páginas 27, 44 e 45, onde consta a orientação quando ao monitoramento dos níveis de carga da bateria:

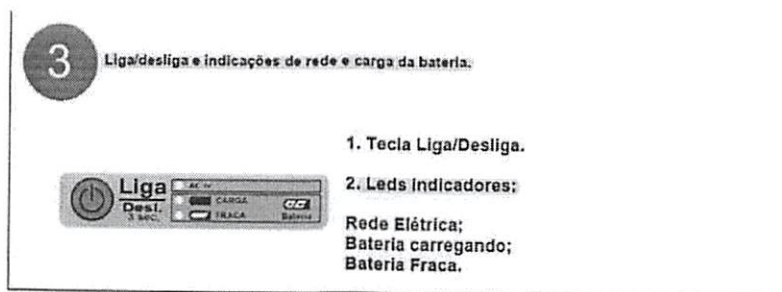

27

STATUS DIGITAL DA CARGA DA BATERIA

No painel do equipamento existe um indicador em forma de LED conforme abaixo:

- ❖ Ligado à rede elétrica: **AC**
- ❖ Estado da bateria (status) **Bateria Carregando:**
- ❖ Estado da bateria (status) **Bateria Descarregada:**

Nível de Carga da Bateria

44

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019




Cardioversor Bifásico VIVO

Indicador: Bateria (display)	Nível da bateria	Autonomia do Equipamento
	100% de carga	Aproximadamente 4 horas de monitoração.
	80% de carga	Aproximadamente 3 horas de monitoração.
	60% de carga	Aproximadamente 2 horas de monitoração.
	40% de carga	Aproximadamente 1 hora de monitoração.
	20% de carga	Aproximadamente 20 minutos de monitoração.

Cabe ressaltar que o nível de carga da bateria é apresentado no Display do equipamento o que é muito mais fácil e eficiente para o profissional visualizar seu status. Pois, o nível de carga na própria bateria traz riscos ao paciente, uma vez que o profissional médico teria que verificar na traseira do equipamento o nível de carga da bateria.

Apresentamos o modelo Beneheart D3 do fabricante Mindray apresentado pela Recorrente Hospcom, o qual possui sua bateria na parte traseira. Desta forma o profissional médico teria que se dirigir a parte posterior do equipamento para verificar o status da bateria.

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR

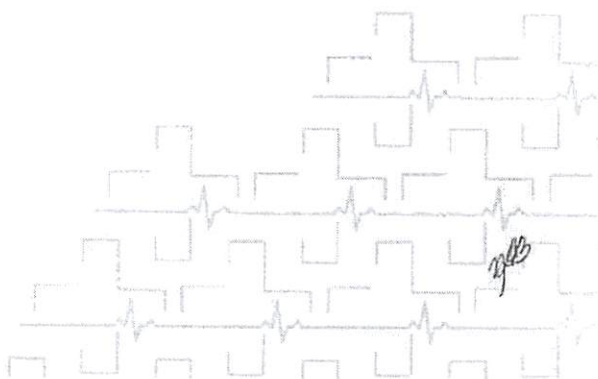



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



2.3.3 Vista posterior

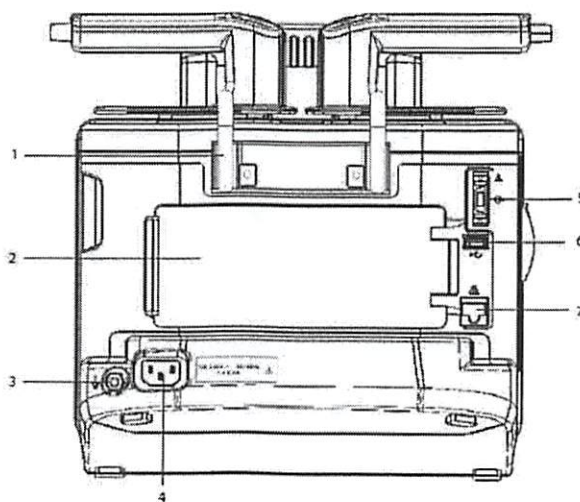

1. Gancho
2. Bateria
3. Terminal de aterramento equipotencial

Quando o desfibrilador/monitor e outros dispositivos são utilizados em conjunto, seus terminais de aterramento equipotenciais devem ser ligados juntos para eliminar a diferença de potencial entre eles.

4. Entrada de alimentação externa

Conecta um cabo de alimentação de CA ou um adaptador de CC/CA para operar o equipamento pela rede externa de CA ou pela fonte de energia de CC, respectivamente.

5. Conector multifuncional

Fornece a saída de ECG e a entrada da sincronização de desfibrilação.

6. Conector USB

7. Conector de rede

É um conector RJ45 padrão.

2-9

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



A Recorrente alega, ainda, que o modelo Vivo não realiza desfibrilação manual com escala selecionável no painel frontal e nas pás de desfibrilação, com botão de seleção de energia, carga e choque.

Trata-se de outra tentativa frustrante do recorrente, pois o equipamento apresentado pela recorrida atende perfeitamente a solicitação, visto que seleciona carga no painel frontal através do Menu, conforme pode ser observado na página 26 do manual registrado na Anvisa:



Cardioversor Bifásico VIVO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES E COMANDOS DO CARDIOVERSOR BIFÁSICO VIVO


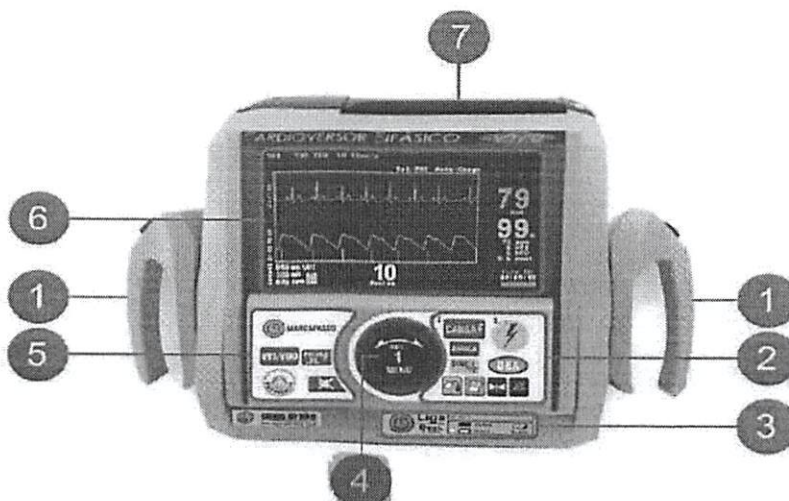


Figura 5 - Partes e Comandos do Cardioversor

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Pás de choque permanentes intercambiáveis adulto/infantil; | 5. Teclas acesso rápido |
| 2. Teclas de acesso Rápido; | 6. Display; |
| 3. Liga/desliga e indicações de rede e carga da bateria; | 7. Alça de transporte; |
| 4. Botão de Navegação e seleção/Confirmação de energia; | |

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



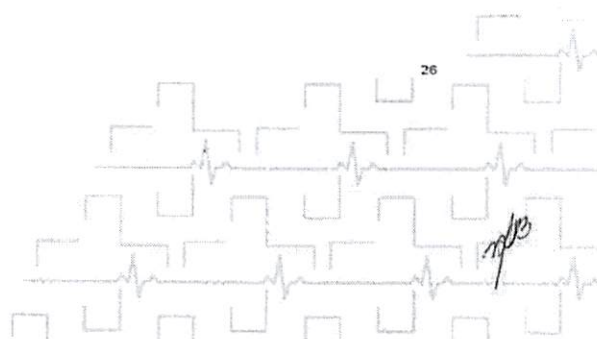

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019




Ainda, nas páginas 75 e 113 é possível verificar que o equipamento seleciona carga também pelas pás:



Cardioversor Bifásico VIVO

9. DESCRIÇÃO DE ACESSÓRIOS

Acessórios Básicos			
Descrição	Código / Ref	Fornecedor	Imagem
CABO DE FORÇA TRIPOLAR	LT7031 / 021	ITALCABOS ITALFLEX ECA ELCOA	
PÁS DE CHOQUE PERMANENTES ADULTO/INFANTIL	LT27275	CMOSDRAKE exclusivamente	

Cargas pré configuradas	O equipamento quando em modo automático, obedece a escala de 150-200 e 200 joules.
Precisão da Energia Entregue	1 a 10Joules - +/- 2J 11 a 360 Joules - +/- 15%
Forma de ativação de Carga	A carga (joules) pode ser selecionada pelas pás, pelo painel e pelo botão navegador, quando selecionado pelas pás, utiliza-se a pá APEX para selecionar a energia, a pá STERNUM para carregar e pressionando simultaneamente os dois botões sendo um em cada pá para disparar, minimizando desta forma o risco de

113



Cardioversor Bifásico VIVO

choques acidentais.
Pelo painel utiliza-se o sistema 1-2-3, 1 para selecionar a energia, 2 para carregar e 3 para disparar (tratamento).

Mais uma vez, demonstramos que o equipamento ofertado pela Recorrida atende as especificações técnicas solicitadas no descritivo e desta forma deve se manter a decisão qual

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR




ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



sagrou-se vencedora do certame, tendo em vista ser a melhor proposta ofertada, no valor de R\$17.402,00.

Por fim, para corroborar todas as alegações da Recorrida, abaixo trazemos a avaliação técnica realizada pelo setor técnico da Prefeitura de Várzea Grande, a qual declarou que:

"A empresa cumpriu com a exigência da especificação técnica do edital."

AVALIAÇÃO TÉCNICA					
FORNECEDOR CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A					
DA APRESENTAÇÃO DOS MANUAIS / CATÁLOGOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
25	CARDIOVERSOR: TIPO BIFÁSICO, COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA, MÓDULO DE BATERIA, DESFIBRILADOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA, COM NÍVEL DE ENERGIA DE ATÉ 360J; POSSIBILIDADE DE DESFIBRILAÇÃO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSAO) E NÃO SINCRONIZADO; DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA, SELECIONÁVEL NO PAINEL FRONTAL E NAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, COM BOTÃO DE SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE, PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA; DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA MÁXIMA EM ATÉ 9 SEGUNDOS COM BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍNUO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 7 POLEGADAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCAPASSO; CAPTAÇÃO DO ECG ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO OU ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS; ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO E PÁS DE DESFIBRILAÇÃO DEVEM UTILIZAR O MESMO CONECTOR; DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO (DEA); DEVE POSSUIR MARCA PASSO; REGISTRO DE ECG ATRAVÉS DE PAPEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50MM, MANUAL OU AUTOMÁTICO, APÓS DESFIBRILAÇÃO OU QUALQUER EVENTO AÇIONADOR DE ALARME; DEVE REALIZAR AUTOTESTE PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO. CARGA	CMOS DRAKE	X	A) VERIFICAR E VALIDAR A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APRESENTADA, INCLUINDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES A LICITANTE E AO PRODUTO SE ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL, BEM COMO SE O MESMO ESTÁ DENTRO DAQUELO QUE A LICITANTE APRESENTOU COMO PROPOSTA; B) AVALIAR TÉCNICAMENTE NO QUE TANGE A QUALIDADE DO MESMO; C) ANALISAR O ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE EM ESPECIAL AQUELAS EXIGIDAS COMO DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.	APRESENTOU CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL. A DO

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

CMOS
DRAKE

EDESCARGA DO CHOQUE E CARGA DA BATERIA: FONTE INTERNA PARA ALIMENTAÇÃO EM REDE ALTERNADA 110/220V AUTOMÁTICO E RECARGA DA BATERIA: BATERIA RECARREGÁVEL DE ION LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 2 (DUAS) HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE ECG SEM A NECESSIDADE DE TROCA OU RECARGA DURANTE ESTE PERÍODO; BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO, AS MESMAS DEVE POSSUIR LEDS DE INDICAÇÃO DO NÍVEL DA CARGA; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A IP44; DEVE PESAR 6KG (+/- 10%) COM A BATERIA INSTALADA; ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO: BOLSA PARA ALOJAMENTO E TRANSPORTE, 01 JOGO DE PÁS REUTILIZÁVEIS CONJUGADAS (CORPO ÚNICO - ADULTO E INFANTIL), 01 CABO DE PACIENTE 05 VIAS, 01 PAR DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA MARCA PASSO, 01 PAR DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA MODO DEA, 05 ELETRODOS DESTACÁVEIS DE AG/AGCL, 01 TUBO DE GEL ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (127 V/220 V), CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ACEITAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITAÇÃO A ETAPA QUE SE SUCEDER À ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZAÇÃO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTÁ OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E COMPROMISSO DE SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA OU DE REPAROS; - DECLARAÇÃO CONTENDO O CRONOGRAMA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, QUE DEVERÃO POSSUIR PERIODICIDADE MÍNIMA DE UMA				
--	--	--	--	--

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



VISITA ANUAL AO SERVIÇO DURANTE TODO O PERÍODO DA GARANTIA DO EQUIPAMENTO; - CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (CBPF). NO CASO DE EQUIPAMENTO IMPORTADO, APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA O FABRICANTE E DETENTOR DO REGISTRO; - DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA USUÁRIOS E TÉCNICOS INDICADOS EM TURNOS DEFINIDOS PELO CONTRATANTE (MANHÃ, TARDE E NOITE, SE NECESSÁRIO); - REGISTRO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTO A ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ / VÁRZEA GRANDE); - MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA QUE PERMITA AO USUÁRIO CONHECER E PODER APLICAR TODAS AS FUNÇÕES E POSSIBILIDADES DO EQUIPAMENTO; - APRESENTAR FOLDERS, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS OU CATÁLOGOS DOS PRODUTOS OFERTADOS, REDIGIDOS EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE CONSTEM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS, PERMITINDO A CONSISTENTE AVALIAÇÃO DOS ITENS.				
PARECER TÉCNICO				
OBSERVAÇÕES A EMPRESA CUMPRIU COM A EXIGÊNCIA DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL.	RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIADOR: <i>[Assinatura]</i> Leticia T. Silva da Silva Secretaria - Administração SUS-10 <i>[Assinatura]</i> Dr. Cassiano Vitor Pereira Assessor Técnico Administrativo RPA e RPA-2019/2020-PMV CMVG/2019-PMV-03-MT			
RESTITUÍMOS O PROCESSO A PREGOEIRA PARA A ANÁLISE E PROVIDÊNCIA VÁRZEA GRANDE, 15 DE ABRIL DE 2019.				

Diante do exposto, devidamente comprovado o atendimento as exigências editalicias solicitamos que a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT, mantenha a

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR




ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



integralidade da decisão proferida pelo i. Pregoeiro que classificou a proposta da RECORRIDA CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A e mantenha-a como vencedora do certame, inclusive por ser a mais vantajosa para o interesse público envolvido nessa contratação.

A Lei de Licitações, em seu artigo 3º assim dispõe:

"Artigo 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração (...)" (grifamos)

Assim, mais que apenas um princípio a busca pela proposta mais vantajosa é a real finalidade da licitação, conforme se vislumbra do dispositivo legal supratranscrito. Nesse sentido preleciona Marçal Justen Filho:

"A licitação busca selecionar o contratante que apresente as melhores condições para atender os reclamos do interesse público, tendo em vista todas as circunstâncias previsíveis (preço, capacitação técnica, qualidade e etc.)"

[...]

A licitação envolve a prática de uma série ordenada de atos jurídicos (procedimento) que permita aos particulares interessados apresentarem-se perante a Administração, competindo entre si, em condições de igualdade. O ideal vislumbado pelo legislador é, por via da licitação, conduzir a Administração a realizar o melhor contrato possível: obter a maior qualidade, pagando o menor preço. Rigorosamente, trata-se de desdobramento do princípio mais básico e fundamental que orienta a atividade administrativa do Estado, toda atuação administrativa se orienta à consecução do interesse público. O administrador não possui disponibilidade do interesse que persegue. Em alguns casos, a Lei faculta ao administrador liberdade para escolher o modo de realizar esse interesse. Surgirá a discricionariedade, que significa, contudo, liberação do administrador quanto ao fim a perseguir. [...] quando a administração recorrer à colaboração de um particular, não estará dispensada do dever de busca do interesse público. Aliás, supõe-se que a convocação à participação do particular retrate a busca do interesse público [...]" (grifamos).

Ou seja, a empresa vencedora do certame deve ter a efetiva capacidade de cumprir o objeto licitado, observado o melhor preço. In casu, a Recorrida comprovou, por meio do equipamento ofertado, possuir capacidade técnica suficiente para a execução do objeto com qualidade indubitável e ofertou um preço vantajoso para a Administração, visto que as

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



Recorrentes ofertaram para o item as seguintes propostas: Recorrente Instramed R\$19.730,00 e Hospcom R\$ 19.996,66.

III - DO PEDIDO

Pela força insuperável dos fatos e das considerações acima expostas e em face dos princípios e regras que norteiam a atuação da Administração Pública, devem os Recursos Administrativo interpostos pelas empresas Recorrentes INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. e HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., ser INDEFERIDO NA INTEGRAL, a fim de que seja mantida a JUSTA E ADEQUADA decisão que classificou a proposta no Pregão Eletrônico n.º 003/2019 a empresa CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A.


Nestes termos,
Pede deferimento.

Nova Lima, 31 de maio de 2019.

Nilmara da Conceição Lucindo Bento

CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A
CNPJ nº 03.620.716/0001-80

NILMARA DA CONCEIÇÃO LUCINDO BENTO
RG Nº MG.12.835.232 / CPF Nº 054.499.216-40
PROCURADORA

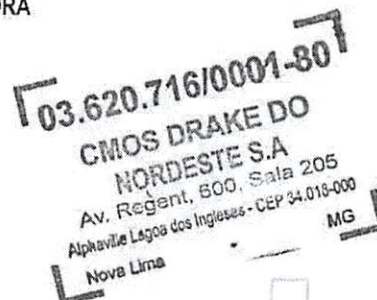

AV. REGENT, 600 - SALA 205
ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES, NOVA LIMA - MG
CEP 34.018-000
(31) 3547-3969
WWW.CMOSDRAKE.COM.BR



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

V - Da Análise

Cumpra registrar, antes de adentrar e rebater os tópicos aventados pelas recorrentes, que o desprovisionamento recursal decorre, inicialmente, do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

O artigo 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital.

Referente à tempestividade da manifestação de recursos apresentada pela empresa **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, foi aberto para manifestação de recurso em 23/05/2018 às 15h00min. , a empresa acima mencionada postou suas intenções recursais conforme consta registrado no portal do bll- Bolsa de Licitações e Leilões.

Tais questionamentos da recorrente dependem da análise técnica realizada pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Vejamos o Parecer Técnico:



Prefeitura Municipal de
VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

CI N. 191/2019/Sup. de Aquisição/SMS

Várzea Grande-MT, 10 de junho de 2019.

A Imo Sra.
Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira

Prezada Senhora,

Pela presente, encaminhamos a resposta do recurso administrativo imputado ao pregão eletrônico nº 03/2019 pelas empresas: INSTRAMED IND. MÉD. HOSPITALAR LTDA. E HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Atenciosamente,

PROTOCOLO Nº	
Data: 10/06/19	Hora: 08:57
Resp: <i>[assinatura]</i>	
Seal de Licitação - P. M. V. G.	

Lucimar Rocha Martins
Lucimar Rocha Martins
Técnico de Nível Superior
Superintendência de Aquisição/SMS

Secretaria Municipal de Saúde - email: gestaosmsvg@gmail.com
Avenida da FEB, nº 2.138, Bairro da Manga, Várzea Grande - MT - 78.115-904 - Fone (65) 3632-1504



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



LICITAÇÃO
PMVG

PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar



SECRETARIA DE SAÚDE

CI Nº 1863/Secundaria/SMS/2019

Várzea Grande, 07 de junho de 2019.

De: Superintendência de Atenção Secundária

Para: Superintendência de Licitação - Pregoeira

Assunto: Resposta do recurso administrativo imputado ao Pregão nº 03/2019 – Menor preço por Item – Sistema de Registro de Preços, no Processo Administrativo nº 561487/2018

Prezado (a),

Encaminho resposta a recurso imputado em processo de licitação de equipamentos hospitalares.

Considerando as disposições regulamentadas no Edital do processo licitatório, bem como as especificações apresentada pelos participantes do mesmo e as contestações feitas pelo Recorrente.

Em resposta a solicitação feita pela empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA de anulação de decisão, declarou que a empresa CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A, vencedora do Item 25 da disputa do Pregão Eletrônico Nº 03/0219 do município de Várzea Grande – MT, declaramos após análise negamos o recurso administrativo do item exposto acima, pois entendemos que a empresa Recorrida atende completamente todas as exigências.

Considerando que Edital prevê DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS (LIGADO COM BATERIA) IGUAL OU SUPERIOR A IP44

Considerando também que o Edital prevê "BATERIAS COM FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCAS PODENDO SER FEITA PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO", aceitamos que a retirada da tampa não se configura como desmontagem o equipamento.



Atenciosamente,

Lucélia Cristina de Lima Lopes
Superintendente de Atenção Secundária
SMS - VG
Lucélia Cristina de Lima Lopes
Superintendente de Atenção Secundária

Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande – Nível Central – Atenção Secundária
Av. da Feb, nº 2138, Manga - Várzea Grande-MT – 78.115-806 – Cel: (65) 98476-6346
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PROC. ADMINISTRATIVO nº561487/2018

Pregão Eletrônico nº03/2019

VI – Da Decisão

A Pregoeira, no uso de suas atribuições e em obediência ao Decreto Federal 3.555/00, Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, em respeito aos princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, **ACATA** o relatório da Equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista que são detentores do conhecimento técnico e responsáveis pela elaboração do termo de referencia INFORMA que em referência aos fatos apresentados e da análise realizada nas razões e tudo o mais que consta dos autos; **DECIDE**;

- a) Receber o Recurso da Recorrente **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº05.743.288/0001-08; e no mérito **JULGAR IMPROCEDENTE**;

Mantendo a empresa **CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.** CNPJ sob nº 03.620.716/0001-80, **Vencedora do item 25.**

Essa é a posição adotada pela Pregoeira e, diante disso, encaminha-se o presente à autoridade superior competente para análise e posterior decisão, com fulcro no Art. 109, § 4º da Lei 8.666/93.

Várzea Grande - MT, 13 de junho de 2019.


Francisca Luzia de Pinho
Pregoeira



DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº. 561487/2019

Pregão Eletrônico nº 03/2019


Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS HOSPITALARES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

De acordo com o Parágrafo 4º do Art. 109 da Lei n. 8.666/63 e com base nas análises efetuadas pela equipe técnica e pregoeira; **RATIFICO** as Decisões Proferidas que **NEGARAM PROVIMENTO** ao Recurso Administrativo interposto pela empresa **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ: sob nº05. 743.288/0001-08 e, **mantendo** a empresa **CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A**, inscrita no CNPJ sob nº 03.620.716/0001-80, **Vencedora do item 25.**

Acolho na íntegra os argumentos e mantenho decisão expendida pela Pregoeira, aos quais adoto como razões de decidir.

De ciência aos Licitantes, após divulgue-se esta decisão junto ao site WWW.bllcompras.org.br e WWW.varzeagrande.mt.gov.br bem como procedam às demais formalidades de publicidades determinadas pela lei.

Várzea Grande, 13 de junho de 2019.

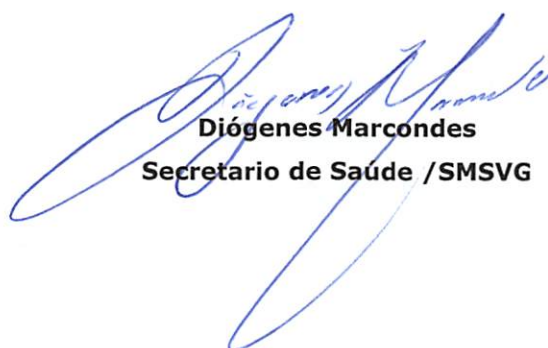

Diógenes Marcondes
Secretario de Saúde /SMSVG