



DE: CADIM – Centro de Armazenamento e Distribuição de Medicamentos - SMS/VG	PARA: PREGOEIRA A/C Julie	DATA: 24/04/2023	C.I. Nº 225/2023
--	----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Assunto: Resposta Pedido de esclarecimento.

Referente a solicitação de esclarecimento da empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, quanto ao descritivo da Bomba de Infusão, e quanto Item 03, 04 e 05 do Lote 01, – Pregão Eletrônico nº16/2023, segue manifestação técnica:

DO QUESTIONAMENTO:

DESCRIPTIVO DA BOMBA DE INFUSÃO

Serão aceitas bombas que possuem detecção de oclusão de 4 níveis? Sendo elas ajustáveis na faixa de 150/300/525/ 900 mmHg?

ITEM 03 – LOTE 01

Serão aceitos equipos sem injetor lateral? Visto que esta especificação específica não impacta na qualidade da infusão e não interfere na segurança do mesmo. Mantendo assim sua função e demais características requisitadas.

ITEM 04 – LOTE 01

Serão aceitos equipos com todas as especificações, porém da cor azul? Visto que esta especificação não impacta na qualidade da infusão e não interfere na segurança do mesmo, diferindo apenas sua coloração, mantendo a mesma função vigente.


ITEM 05 – LOTE 01

Serão aceitos extensores de perfusão com comprimento de no mínimo 120 cm? Ressaltando que é uma variação de apenas 20%, onde não há prejuízo em seu uso. Mantendo a qualidade

CADIM- CENTRO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS

Av da Feb , Nº 2138 – PONTE NOVA - VÁRZEA GRANDE – MT.

FONE: 65-98475-7218

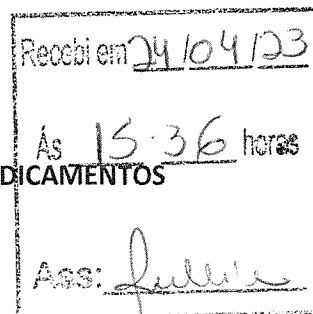



DO ESCLARECIMENTO:

DESCRIPTIVO DA BOMBA DE INFUSÃO

O item deve ser ofertado conforme descritivo do edital.

ITEM 03 – LOTE 01

O item deve ser ofertado conforme descritivo do edital.

ITEM 04 – LOTE 01


O item deve ser ofertado conforme descritivo do edital.


ITEM 05 – LOTE 01

O descritivo solicita comprimento “aproximado de 150cm”, permitindo variações, sendo assim será admitido.

Sem mais para o momento, coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Gideão Boanéz do Prado
Gestor Público CADIM/SMS/VG

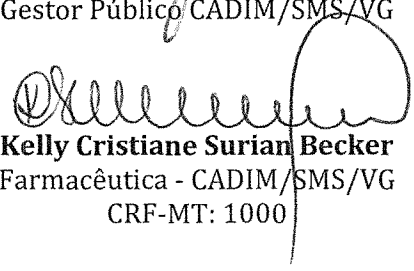
Kelly Cristiane Surian Becker
Farmacêutica - CADIM/SMS/VG
CRF-MT: 1000

Goiânia, 20 de abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023
PROCESSO Nº 851769/2022
ABERTURA DIA 27/04/2023 ÀS 10:00 HS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

À Comissão permanente de Licitação

A HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, registrada no CNPJ nº 05.743.288/0001-08, situada na rua 104, nº74, setor sul, Goiânia – GO, vem por meio desta, solicitar respeitosamente, esclarecimento 851769/2022, que tem como objeto é “é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipos, seringas e extensores com cessão de bombas de infusão e bombas de seringa em regime de comodato de equipamentos, para atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande - MT.”

Senhores, com base nas especificações do edital para a BOMBA DE INFUSÃO a ser ofertada em comodato, gostaríamos de apresentar o esclarecimento abaixo:

É descrito que a bomba de infusão deva apresentar: “*Detector de oclusão ajustável em no mínimo 10 níveis, de acordo com as condições do paciente e viscosidade da solução*”.

Há o questionamento se é realmente necessário possuir no mínimo 10 níveis de oclusão, pois com níveis menores de faixa é possível manter a segurança e cuidado necessário para a terapia.

Serão aceitas bombas que possuem detecção de oclusão de 4 níveis? Sendo elas ajustáveis na faixa de 150/300/525/ 900 mmHg?

Vale ressaltar que este quesito não impacta na segurança e infusão de medicamentos para o paciente.

Com relação ao item 3 do lote I, é solicitado: *“Equipo de bomba de infusão para administração de nutrição parenteral, fotossensível compatível com a bomba de infusão, seguindo a isso 8536-8.is.p, com pinça tipo rolete, com injetor lateral, clamp antirrefluxo livre, conector no luer, conector longo no luer, tubo e câmara foto, filtro 0,2 mc, bureta de precisão, conector luer lock. dimensões aproximadas: equipo: 1,50 m a 3,0 m”.*

Serão aceitos equipos sem injetor lateral? Visto que esta especificação específica não impacta na qualidade da infusão e não interfere na segurança do mesmo. Mantendo assim sua função e demais características requisitadas.

Com relação ao item 4 do lote I, é solicitado: *“Equipo para nutrição enteral com filtro de ar para uso administração de soluções de nutrição enterais de uso geral, seguindo a padronização vigente de cor lilás para identificação de uso enteral. confeccionado com matéria prima atóxica com ponta perfurante com conexão universal, com filtro de ar que facilita a colabagem do frasco de nutrição; com pinça rolete para controlar o fluxo da dieta, garantindo excelente precisão no controle do gotejamento; com conector escalonado incompatível com dispositivos de infusão intravenosa, conectando-se apenas com a sonda de nutrição enteral”.*


Serão aceitos equipos com todas as especificações, porém da cor azul? Visto que esta especificação não impacta na qualidade da infusão e não interfere na segurança do mesmo, diferindo apenas sua coloração, mantendo a mesma função vigente.

Com relação ao item 5 do lote I, é solicitado: *“Extensor de perfusão para utilização em bombas de seringa, recomendado pelo fabricante do equipamento para administração de soluções parenterais por bomba de seringa; estéril de uso único; descartável aterogênico, atóxico tubo de comprimento aproximado de 150 cm em material pe (polietileno) transparente, flexível, livre de látex, terminais conectores tipo luer lock macho e fêmea com tampas protetoras de fixação firme e de fácil remoção. diâmetros internos e externos de 1.0 e 2.0 mm, respectivamente, prime aproximadamente 1,2 ml e french 3. embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante procedência, esterilização validade, número de lote”.*

Serão aceitos extensores de perfusão com comprimento de no mínimo 120 cm?
Ressaltando que é uma variação de apenas 20%, onde não há prejuízo em seu uso. Mantendo a qualidade e devida função para que se é destinado.

Entendemos que esse tipo de conexão, também é efetiva e trará facilidade ao usuário, pois permite que não fique conectado a um cabo.

Desde já agradeço a compreensão.

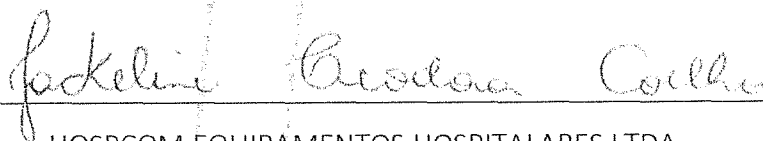

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Jackeline Teodora Coelho

Representante Legal

RG 685950 SSP/TO

CPF 015.305.151-57

(62) 3241-5555

licitacao1@hospcom.net